



A Sysmex Group Company



## SHOX Probe

RÉF. : LPU 025-SA / LPU 025-A

**Réactif spécifique à un analyte : les caractéristiques de performance et d'analyse ne sont pas établies.**


L'hybridation *in situ* en fluorescence (FISH) est une technique qui permet aux séquences d'ADN d'être détectées sur les chromosomes métaphasiques ou dans les noyaux interphasiques d'échantillons cytogénétiques fixés. Elle emploie des sondes d'ADN qui s'hybrident au chromosome entier ou à des séquences simples uniques et sert de puissant complément à la cytogénétique traditionnelle. De récentes avancées font que cette précieuse technique peut désormais être appliquée comme outil essentiel dans le cadre de l'analyse chromosomique prénatale, hématologique et pathologique. L'ADN cible, une fois fixé et dénaturé, peut être recuit sur une sonde d'ADN dénaturée de façon similaire et marquée par fluorescence qui est équipée d'une séquence complémentaire. Après l'hybridation, la sonde d'ADN non liée et non spécifiquement liée est retirée, et l'ADN est contre-coloré en vue de la visualisation. La microscopie en fluorescence permet ensuite de visualiser la sonde hybridée sur le matériau cible.

### Caractéristiques des sondes

Sonde de la région SHOX, Xp22.33/Yp11.32 en rouge

Sonde de la région DYZ1, Yq12 en vert

Sonde de la région DXZ1, Xp11.1-q11.1 en bleu

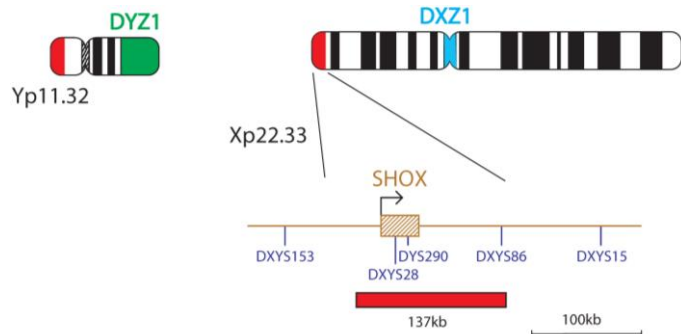

La sonde SHOX de 137kb, marquée en rouge, couvre une région englobant la totalité du gène SHOX et l'ADN adjacent sur les chromosomes Y et X. Le mélange de sondes contient également des sondes de contrôle pour le centromère du chromosome X (DXZ1), marquées en bleu, et pour le chromosome Y (DYZ1, le bloc hétérochromatique au niveau de Yq12), marquées en vert.

### Matériaux fournis

**Sonde :** 50µl ou 100µl par flacon

**Concentration de la sonde :** Quantité de sonde SHOX rouge : 1.75 – 2.95ng/µl  
Quantité de sonde DYZ1 vert : 2.40 – 3.60ng/µl  
Quantité de sonde DXZ1 vert : 10.2 – 14.6ng/µl

La sonde est fournie dans une solution d'hybridation (formamide ; sulfate de dextrane ; SSC) et prête à l'emploi.

### Avertissements et précautions

1. Pour une utilisation professionnelle uniquement.
2. Portez des gants lors de la manipulation des sondes d'ADN.
3. La sonde contient du formamide, qui est tératogène. N'inhaliez pas les vapeurs et évitez tout contact avec la peau. Portez des gants et une blouse de laboratoire, et manipulez sous une hotte. Lors de la mise au rebut, rincez avec une grande quantité d'eau.
4. Mettez au rebut toutes les matières dangereuses conformément aux directives de votre institution en matière de mise au rebut des déchets dangereux.
5. Visuellement, les opérateurs doivent être en mesure de faire la différence entre le rouge, le bleu et le vert.

### Stockage et manipulation

Stockez la sonde entre -25°C et -15°C jusqu'à la date d'expiration indiquée sur l'étiquette. Stockez la sonde à l'abri de la lumière. Assurez-vous que la sonde n'est exposée aux lumières de laboratoire que de façon limitée, à tous moments.

### Réaction croisée connue

Aucune réactivité croisée connue.

### Informations supplémentaires

Pour plus d'informations sur le produit, contactez le Service d'assistance technique CytoCell.

Tél. : +44 (0)1223 294048

E-mail : techsupport@cytoCELL.com

Site Web : www.ogt.com

### Légende des symboles utilisés

REF	fr: Référence du catalogue
IVD	fr: Dispositif médical de diagnostic in vitro
LOT	fr: Code du lot
	fr: Consulter la notice d'utilisation
	fr: Fabricant
	fr: Utiliser jusqu'au
	fr: Limites de température
CONT	fr: Contenu

### Brevets et marques déposées

CytoCell est une marque commerciale de CytoCELL Ltd.

### CytoCELL Ltd.

Oxford Gene Technology,  
418 Cambridge Science Park,  
Milton Road,  
Cambridge, CB4 0PZ, UK  
Tél. : +44(0)1223 294048  
Télécopie : +44(0)1223 294986  
E-mail : probes@cytoCELL.com  
Site Web : www.ogt.com

